

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Máy tạo nhịp tim tạm thời 2 buồng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
- Địa chỉ nhận báo giá:

Gửi về Văn thư của Bệnh viện, Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (các đơn vị cung cấp báo giá phải ghi tiêu đề kèm theo số thông báo bên ngoài bì thư: **yêu cầu báo giá số.2.05.2/TB-BV ngày 2.2.1.5.2024 về việc Máy tạo nhịp tim tạm thời 2 buồng**)

3. Thông tin liên hệ:

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 0235.3870390 Nhánh lẻ 2500 (trong giờ hành chính)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11.giờ.15.phút ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến trước 11.giờ.15.phút ngày 03 Tháng 6 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá trọn gói danh mục thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy tạo nhịp tim tạm thời 2 buồng	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO13485 hoặc tương đương	02	Cái

II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH:

- Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:

Bao gồm:

- + Thân máy chính: 01 cái
- + Cáp nối : 02 cái
- + Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh kèm bản dịch tiếng Việt: 01 bản

III. Các tính năng và thông số kỹ thuật:

Chế độ hoạt động: DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO

Tần số tạo nhịp cơ bản: 30-200 nhịp/ phút

Tần số tạo nhịp tối đa: 80-230 nhịp/ phút

Tần số tạo nhịp nhanh nhĩ: 80-800 nhịp/ phút

Biên độ xung: Nhĩ: 0.1 – 20 mA; Thất: 0.1 – 25 mA

Độ rộng xung: Nhĩ: 1.0 ms; Thất: 1.5 ms

Độ nhạy: Nhĩ: 0.4 – 10 mV; Thất: 0.8 – 20 mV

Khoảng AV:

- Paced A-V: 50-250 tự động chỉnh; 200 – 300 chỉnh tay

- Sensed A-V: 50 -250

Thời kỳ trơ:

- Nhĩ: 150 – 500 ms (PVARP);

- Thất: không có

Thời kỳ trống của thất: Pace: 200 ms; Sense: 120 ms

Kích thước: Dài 20.3 cm; Rộng 8.6 cm; Cao 4.45 cm

Trọng lượng: 680 g

Loại pin: Pin 1.5 V Alkaline, Loại AA: Duracell MN1500, Eveready E91 hoặc tương đương

Tuổi thọ pin: Thường là 9 ngày, tối thiểu 7 ngày.

IV. Các yêu cầu khác:

- Bảo hành tối thiểu: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng

- Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

- Địa điểm giao hàng: tại Bên mua

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng < 48 giờ



		<ul style="list-style-type: none"> - Cam kết cung cấp chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi bàn giao đối với hàng nhập khẩu. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng - Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao tối thiểu 5 năm - Cam kết đảm bảo dịch vụ và có chào giá bảo trì sau bảo hành - Cam kết cung cấp Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt 		
2	Dây điện cực tạo nhịp tạm thời	<ul style="list-style-type: none"> • Chất liệu woven tương thích sinh học, mềm ở nhiệt độ cơ thể và thích ứng với màng trong tim • Bóng bằng latex có thể tích lên tới 1.5 ml, thiết kế của bóng hỗ trợ đặt dây dễ dàng không cần X-quang. • Kích thước thân tùy chọn 5F • Điện cực thứ nhất nằm ở đầu xa dây điện cực • Điện cực thứ hai cách điện cực thứ nhất khoảng 1cm. • Kèm theo kim, syringe, ECG adapter, Safety Adapter 	02	Cái

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có)


- Báo giá phải niêm phong kín.

- Báo giá kèm theo giấy ủy quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VT-TBYT

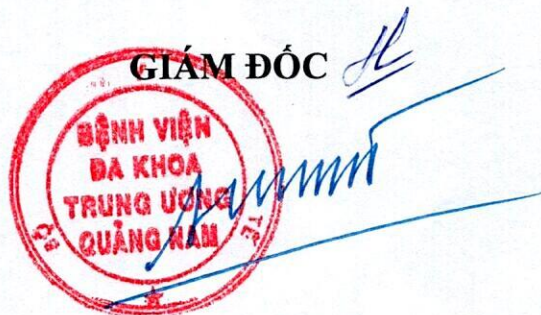

Nguyễn Đình Hùng

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:...../TB-BV ngày...../...../.....của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chúng tôi, địa chỉ:...[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền
1											
2											
3											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ≥ 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 202..

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))